

医療サイドからのニーズ

大田医療産業機構

専務理事

脳神経外科医、氏家 弘


手術室で使用される鋼製小物(ハサミ、メス、撮子)の種類は多い
改良品へのニーズは高い

OtaMI3は 鋼製小物の実物の展示会をします！




顕微鏡手術、内視鏡手術の視野は狭く、深い
現在の手術機器は手になじまない

Ota MI3は どこに問題があるか手術ビデオで説明します！


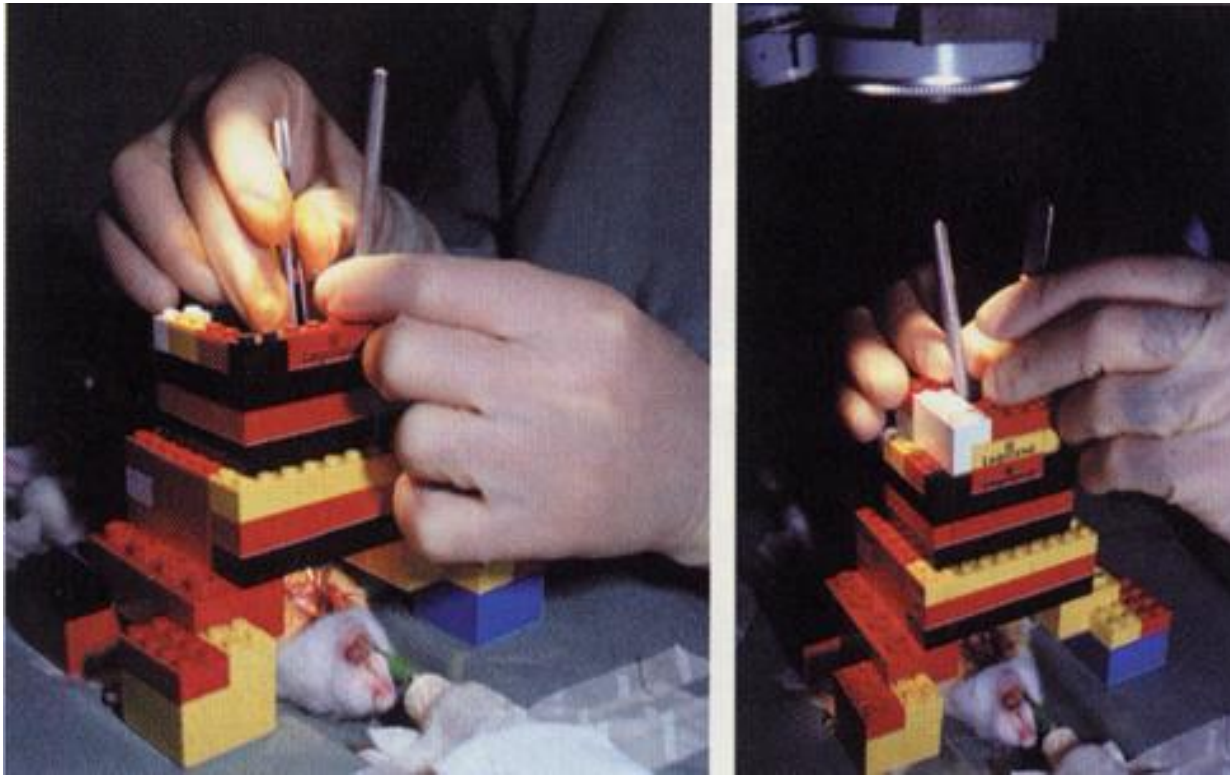


脳梗塞、心筋梗塞を予防する次世代小口径Covered stentは
まだ製品化されていません



OtaMI3は 共同開発を提案します

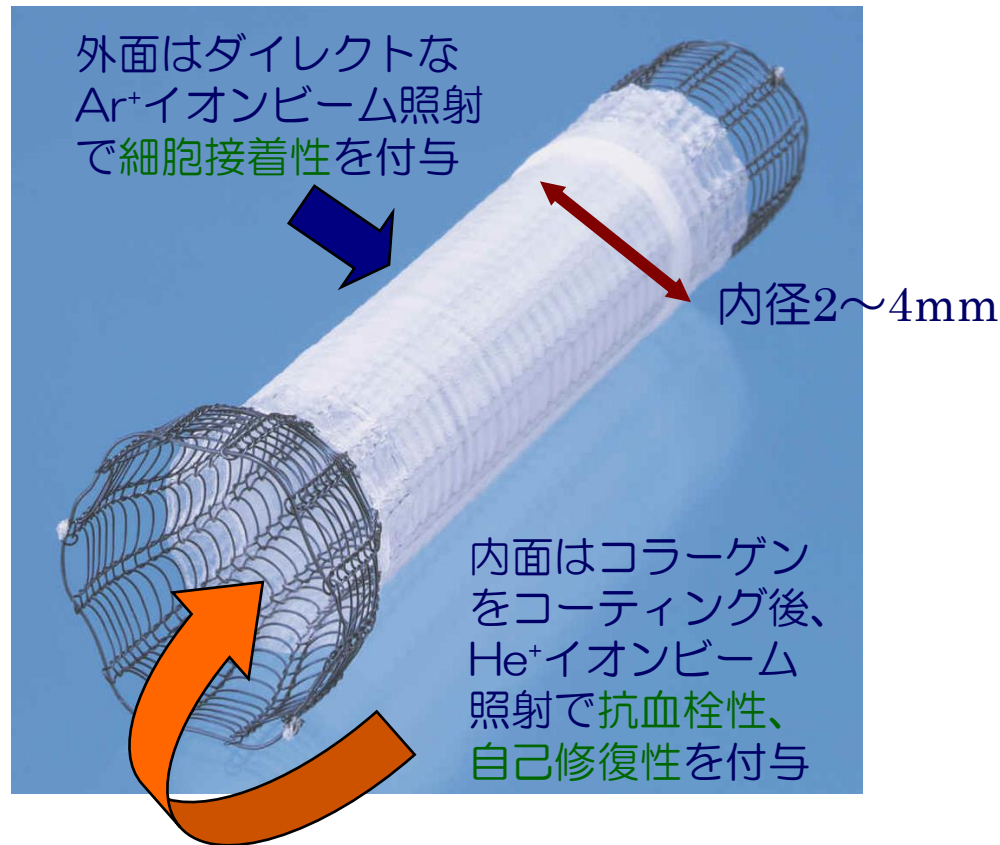

手術時に有用な生体パッチの製品開発 OtaMI3は製品化を希望する企業を探しています

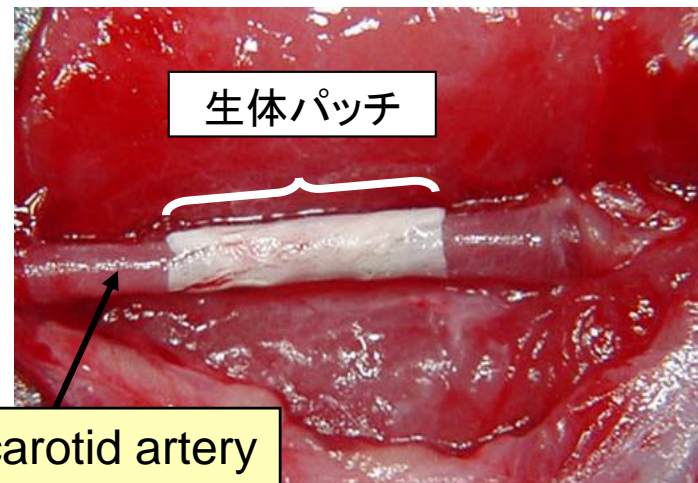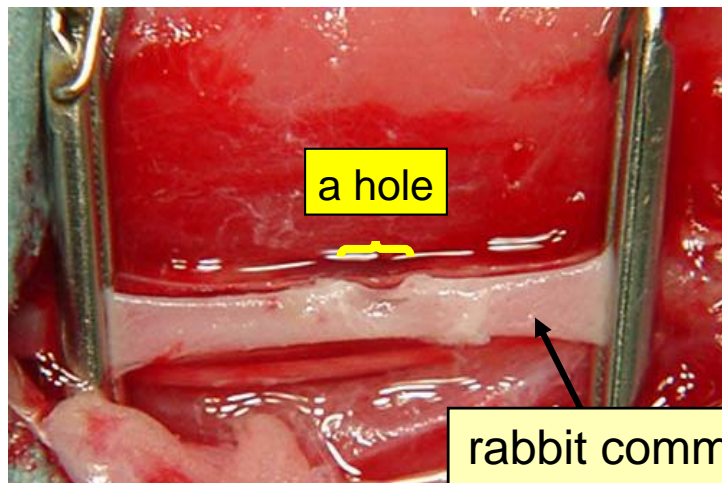

生体パッチはすでに研究開発は終わっています

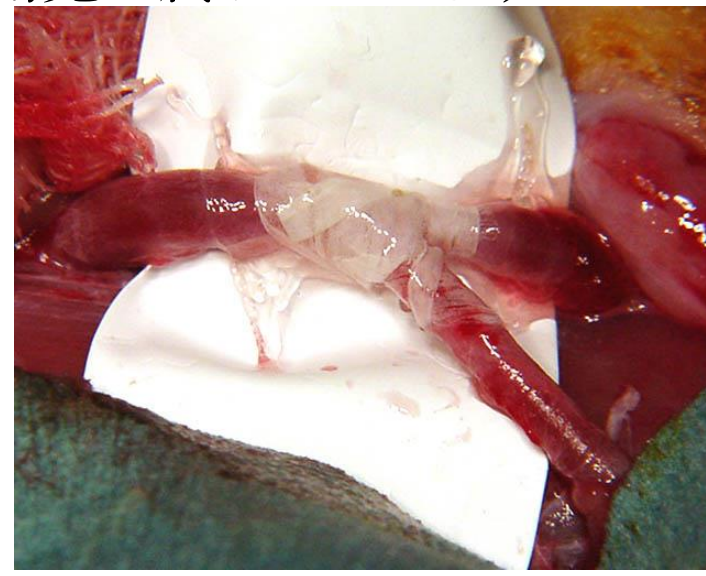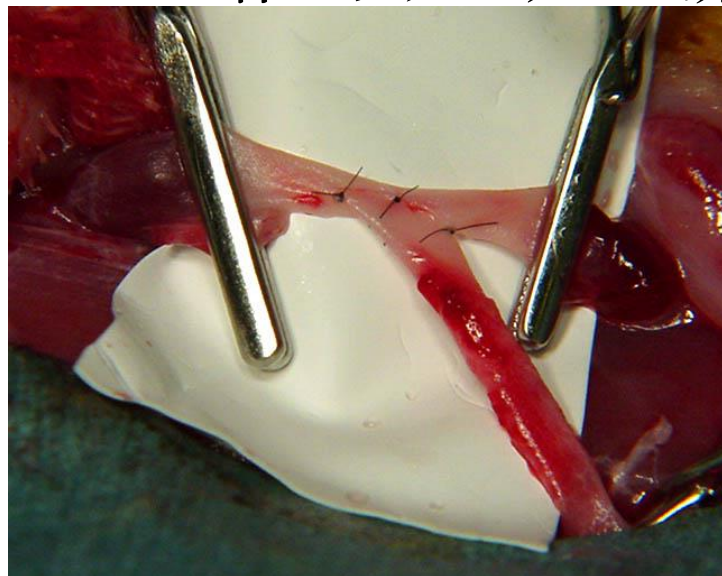

医療機器のほか、

健康: サプリメントの開発

福祉: 筋力低下を補うロボットの開発

医食同源: 糖尿病や高血圧にならない食事の開発

病院の機能: ホテルと同じ、ベット、大部屋内個室の開発
等を提案します。